


**HEINE OPTOTECHNIK**

Ларингоскопы

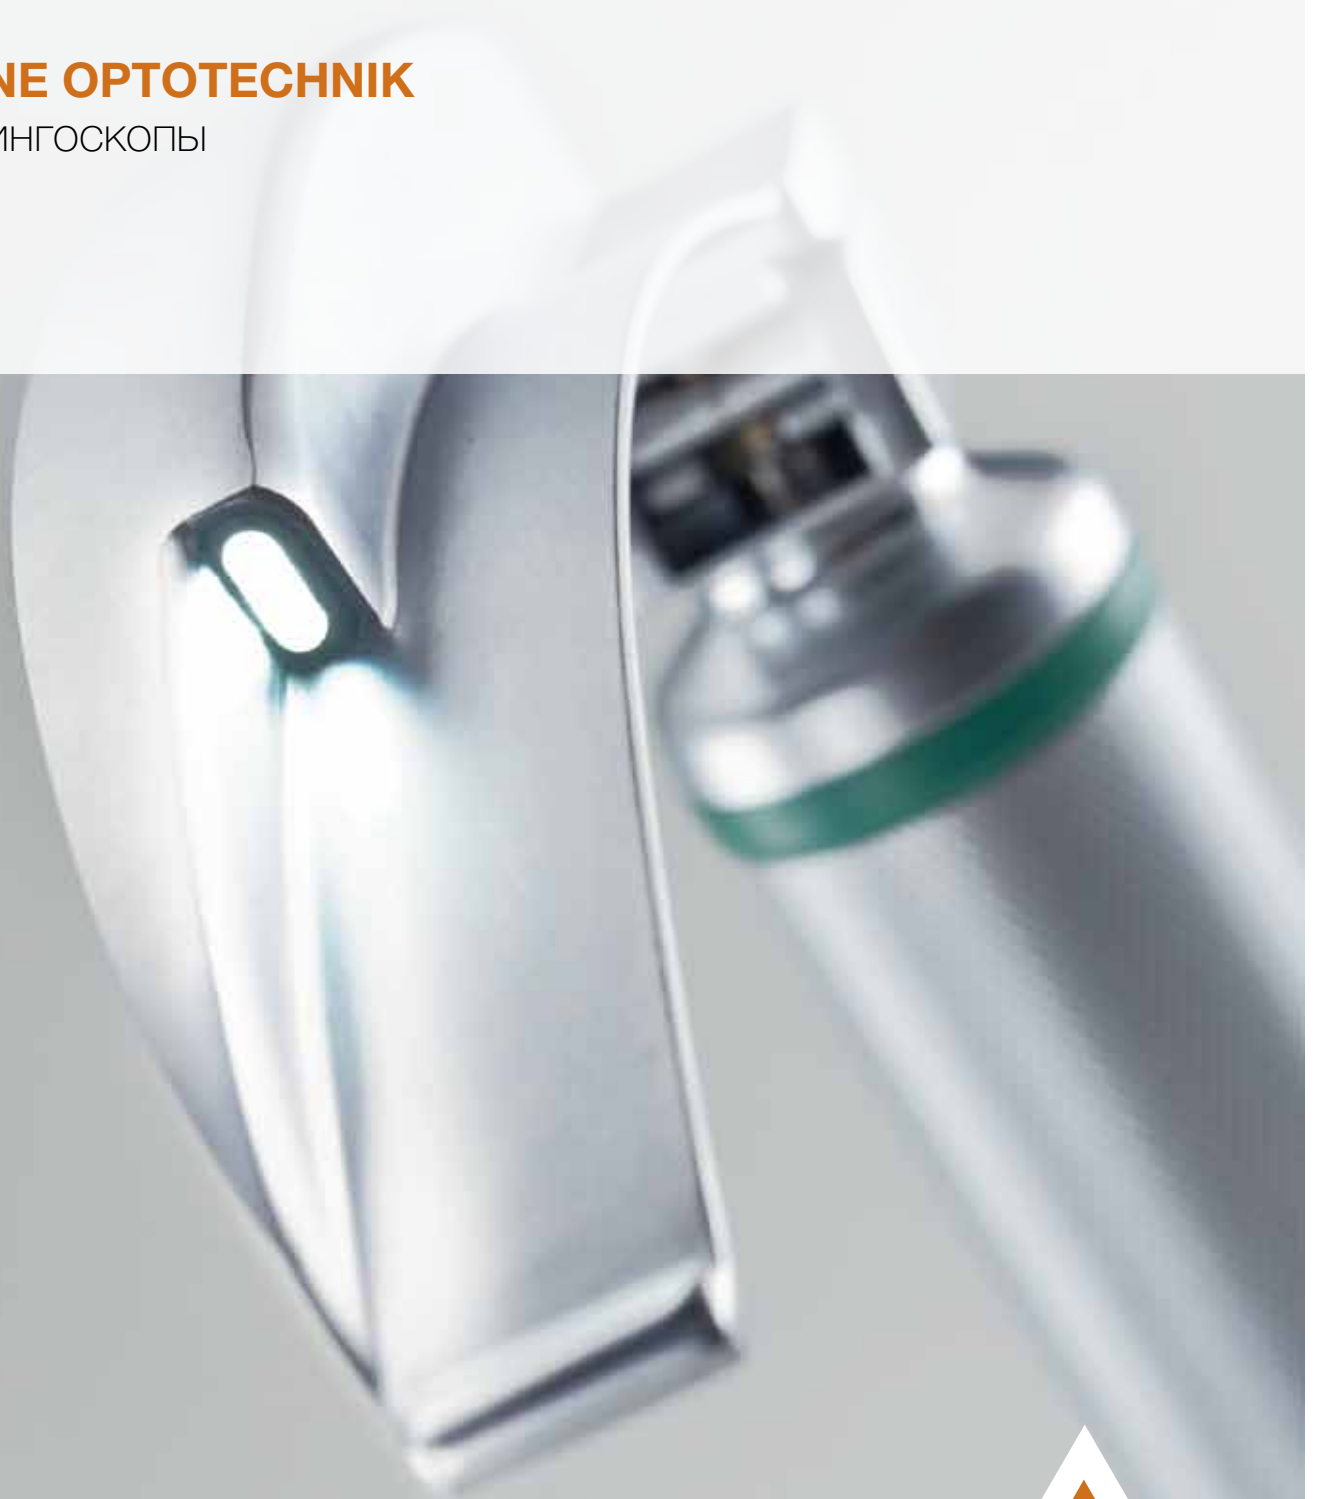

## Ф.О. ларингоскопические наборы HEINE Classic+®

## Набор клинков Paed 1, Mac 2, Mac 3 с запасной лампой и кейсом на молнии.



Наборы Classic+	2,5 В	3,5 В NiMH	3,5 В LI ION L
С батарейной рукояткой Standard F.O.	<b>F-119.10.860</b>		
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O., NiMH аккумулятором и зарядным блоком NT 300		<b>F-119.20.865</b>	
Ⓛ С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. L и зарядным блоком NT 300			<b>F-119.29.865</b>

Аналогичен наборам выше, но без запасной лампы, со светодиодным освещением (LED)



LED Наборы Classic+	2,5 В	3,5 В NiMH	3,5 В LI ION L
С батарейной рукояткой Standard F.O. LED	<b>F-119.18.860</b>		
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. LED, NiMH аккумулятором и зарядным блоком NT 300		<b>F-119.28.865</b>	
Ⓛ С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. L LED и зарядным блоком NT 300			<b>F-119.98.865</b>

## Набор клинков Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4 с запасной лампой и кейсом на молнии.



Наборы Classic+	2,5 В	3,5 В NiMH	3,5 В LI ION L
С батарейной рукояткой Standard F.O.	<b>F-120.10.860</b>		
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O., NiMH аккумулятором и зарядным блоком NT 300		<b>F-120.20.865</b>	
Ⓛ С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. L и зарядным блоком NT 300			<b>F-120.29.865</b>

Аналогичен наборам выше, но без запасной лампы, со светодиодным освещением (LED)



LED Наборы Classic+	2,5 В	3,5 В NiMH	3,5 В LI ION L
С батарейной рукояткой Standard F.O. LED	<b>F-120.18.860</b>		
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. LED, NiMH аккумулятором и зарядным блоком NT 300		<b>F-120.28.865</b>	
Ⓛ С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. L LED и зарядным блоком NT 300			<b>F-120.98.865</b>

Ⓛ Перезаряжаемая рукоятка с индикатором заряда на нижнем модуле.

## Ф.О. ларингоскопические наборы HEINE FlexTip+®



**Ф.О. ларингоскопический набор FlexTip+ с клинком Мас 3, запасной лампой и кейсом.**

Наборы FlexTip+	2,5 В	3,5 В NiMH	3,5 В LI ION
С батарейной рукояткой Standard F.O.	<b>F-227.10.860</b>		
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O., NiMH аккумулятором и зарядным блоком NT 300		<b>F-227.20.865</b>	
Ⓛ С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. L и зарядным блоком NT 300			<b>F-227.29.865</b>

Аналогичен наборам выше, но без запасной лампы, со светодиодным освещением (LED)



LED Наборы FlexTip+	2,5 В	3,5 В NiMH	3,5 В LI ION
С батарейной рукояткой Standard F.O. LED	<b>F-227.18.860</b>		
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. LED, NiMH аккумулятором и зарядным блоком NT 300		<b>F-227.28.865</b>	
Ⓛ С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. L и зарядным блоком NT 300			<b>F-227.98.865</b>
Кейс для наборов FlexTip+ F.O. F-227, F-229 или F-230			<b>F-227.01.000</b>

## Ф.О. ларингоскопические наборы HEINE Mac Modular+®



**Набор клинков Мас 1, Мас 2, Мас 3 и Мас 4 с запасной лампой и кейсом на молнии.**

Наборы Modular+	2,5 В	3,5 В NiMH	3,5 В LI ION
С батарейной рукояткой Standard F.O.	<b>F-228.10.860</b>		
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O., NiMH аккумулятором и зарядным блоком NT 300		<b>F-228.20.865</b>	
Ⓛ С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. L и зарядным блоком NT 300			<b>F-228.29.865</b>

Аналогичен наборам выше, но без запасной лампы, со светодиодным освещением (LED)



LED Наборы Modular+	2,5 В	3,5 В NiMH	3,5 В LI ION
С батарейной рукояткой Standard F.O. LED	<b>F-228.18.860</b>		
С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. LED, NiMH аккумулятором и зарядным блоком NT 300		<b>F-228.28.865</b>	
Ⓛ С перезаряжаемой рукояткой Standard F.O. L и зарядным блоком NT 300			<b>F-228.98.865</b>



Ларингоскопы HEINE



Classic+ Macintosh   Classic+ Miller   Classic+ WIS   Classic+ Paed   Modular+ Macintosh   Modular+ Miller   FlexTip+ Macintosh   SANALON+ Macintosh   SANALON+ Paed   SANALON+ Miller   XP Macintosh   XP Miller

	Размер											
00		<input type="checkbox"/>										
0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>
3a	<input type="checkbox"/>											
3m							<input type="checkbox"/>					
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>											
	Материал											
Нержавеющая сталь	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
SANALON					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Поликарбонат/акрил											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Диаметр Ф.О. пучка HiLite (мм)											
	4,3	3,7	3,7	3,6	3,4	3,0	4,3	3,6	3,6	3,7	—	—
	Многоразовые/стерилизуемые											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Стерилизация без разборки											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Для работы в условиях низких температур											
								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Гарантия											
5 лет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4000 циклов автоклав-яч	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**  
 Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany  
 Tel.: +49 (0) 81 52-38 0 · Fax: +49 (0) 81 52-3 82 02  
 info@heine.com

**HEINE CIS Representative WEST MEDICA**  
 Hegelgasse 19 · A-1010 · Vienna · Austria  
 Tel.: +43 (1) 804 81 84 · Fax: +43 (1) 804 81 85  
 vienna@westmedica.com

www.heine.com · www.heineopto.ru

**HEINE Russia Representative WEST MEDICA**  
 ул. Шереметьевская 85 · стр. 2 · Москва · 129075  
 Tel.: +7 (495) 940-61-33 · Факс: +7 (495) 619-98-84  
 moscow@westmedica.com

Санкт-Петербург: (812) 324-27-78  
 Ростов-на-Дону: (863) 268-94-81  
 Пермь: (342) 220-65-51  
 Новосибирск: (383) 227-67-34

Официальный дистрибьютор